




Přehled produktů pro chemiluminiscenční imunoanalýzu (CLIA)

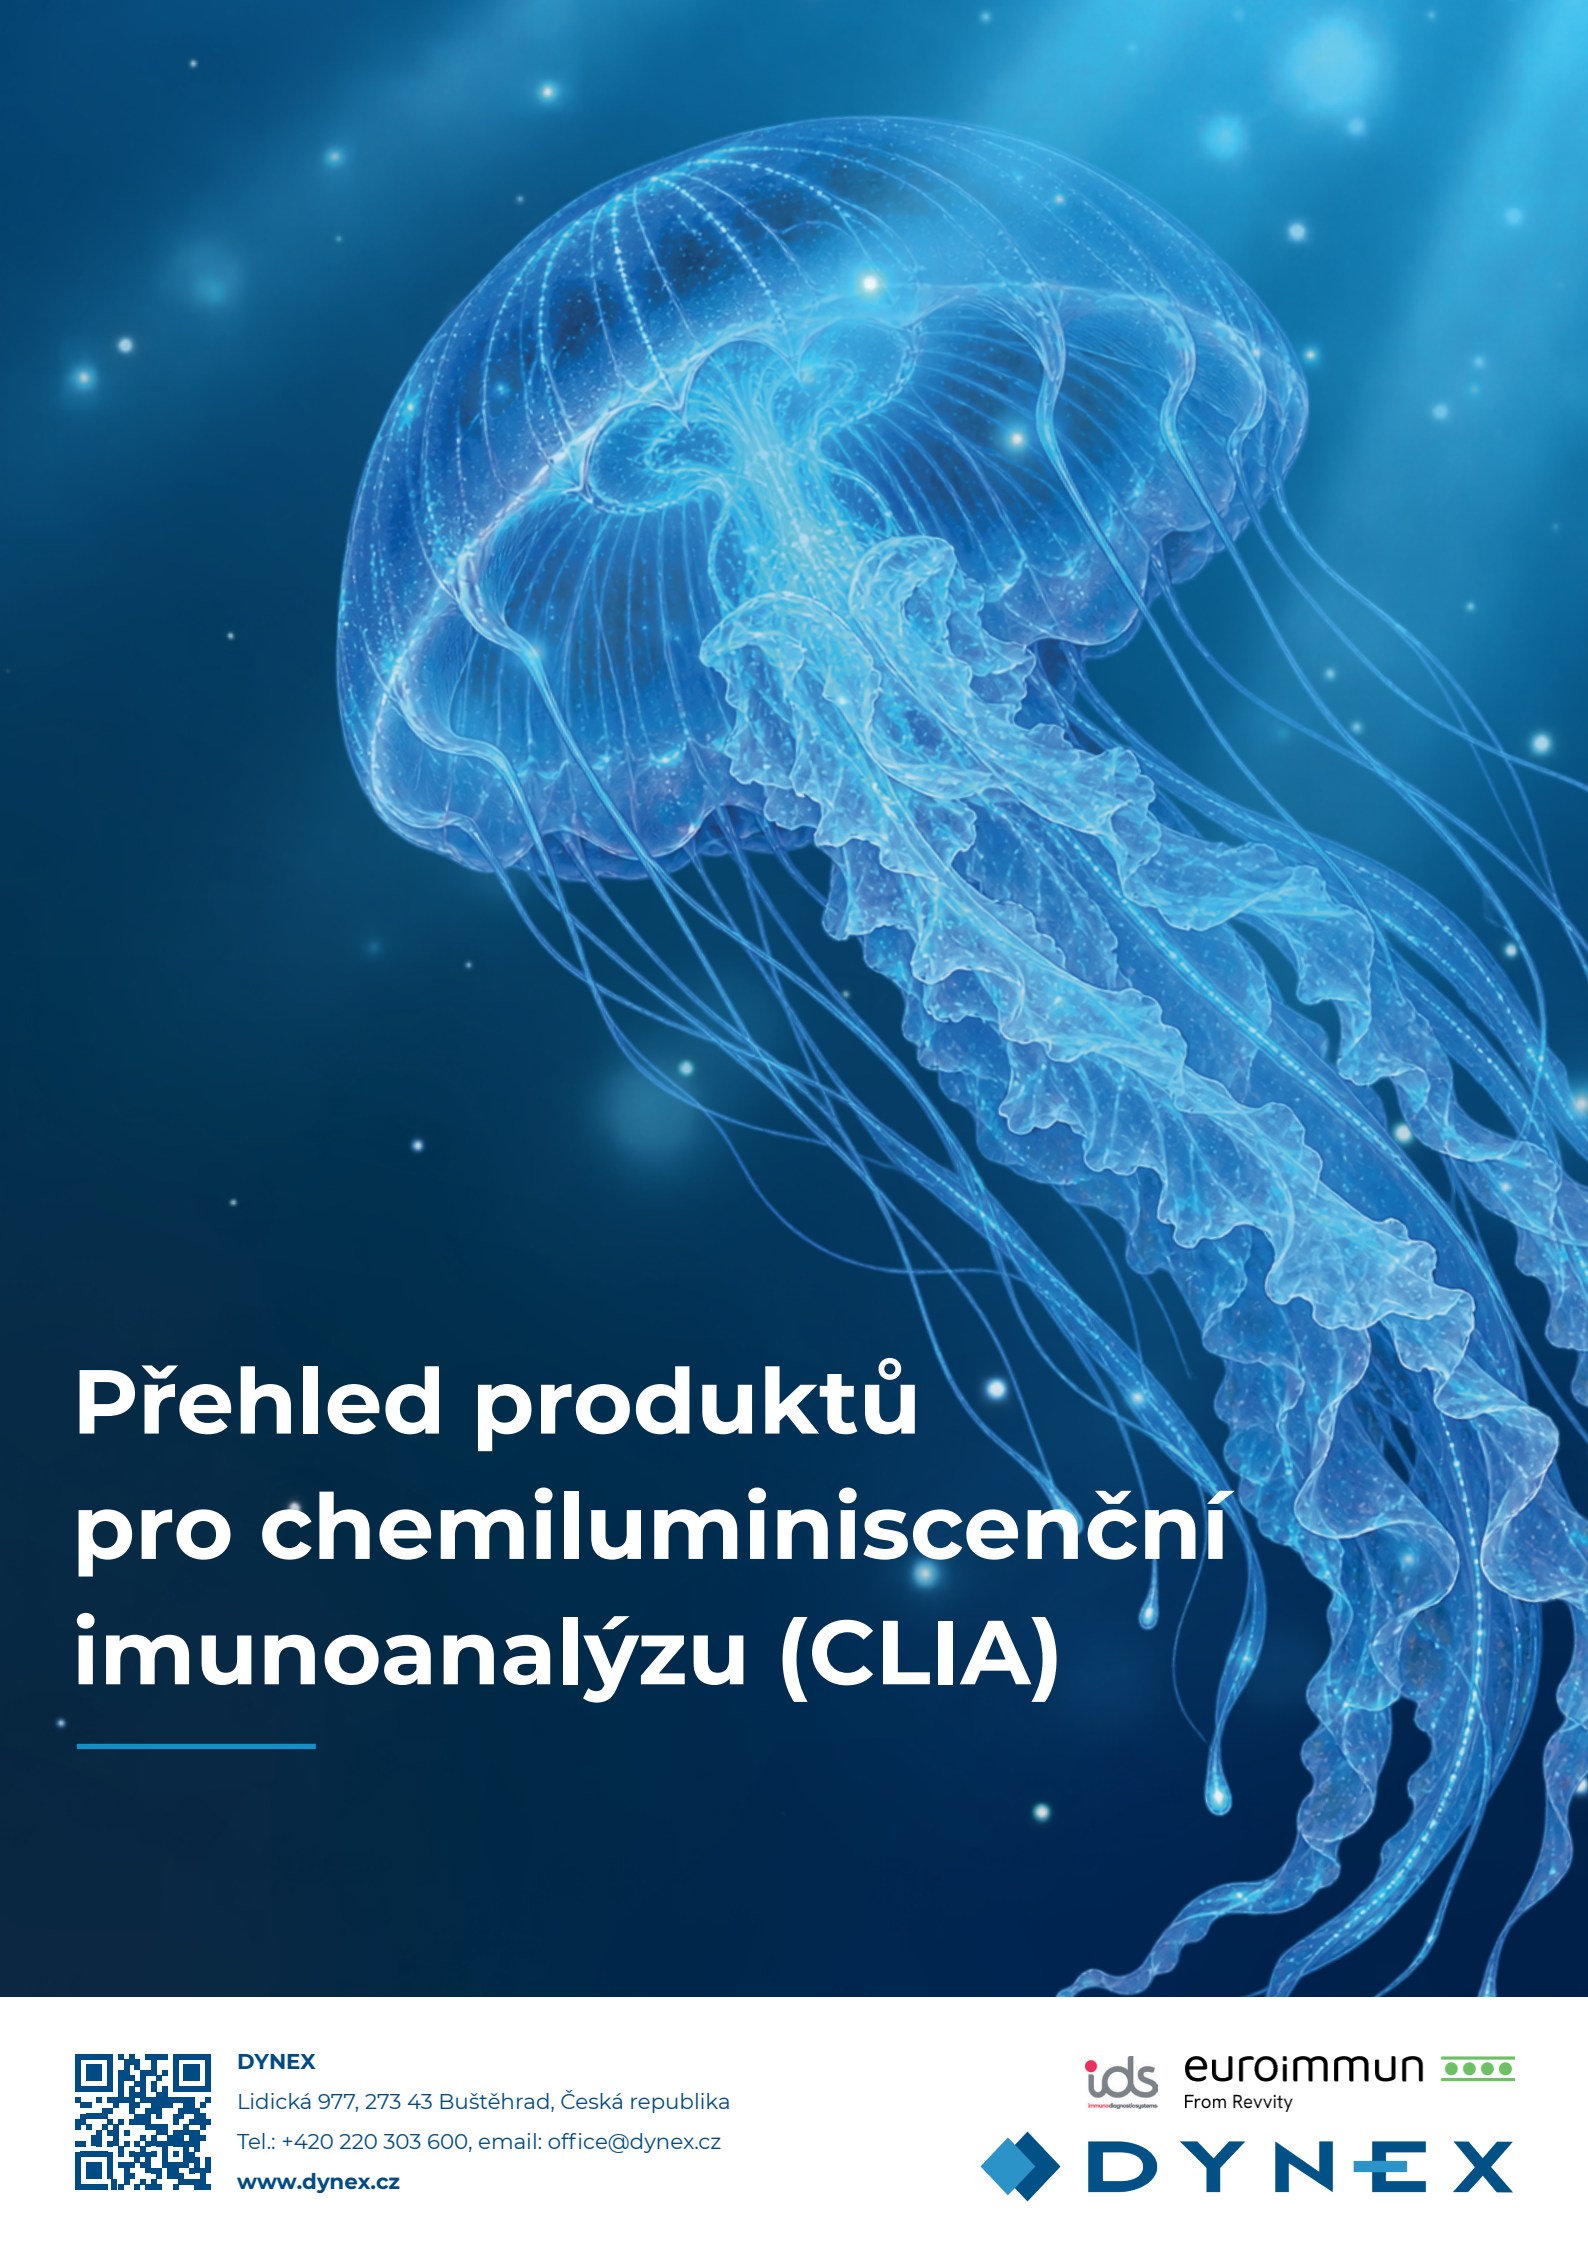

DYNEX

Lidická 977, 273 43 Buštěhrad, Česká republika

Tel.: +420 220 303 600, email: office@dynex.cz

www.dynex.cz



euroimmun 
From Revvity



DYNEX

Autoimunita

Analyt	Obj. č.		Přístroj			Počet testů
	Testovací systém	Kontroly	i10	iSYS	i20	
Revmatologie						
Anti-dsDNA, centromera B, SS-A/Ro (60 kDa a 52 kDa), SS-B/La, Sm, U1-snRNP (70 kDa, A a C), Scl-70 a Jo-1, IgG	IS-AI1001	IS-AI1030	●	●	●	100
Anti-SS-A/Ro (60 kDa a 52 kDa), SS-B/La, Sm, U1-snRNP (70 kDa, A a C), Scl-70 a Jo-1, IgG	IS-AI1002		●	●	●	
Anti-dsDNA, IgG	IS-AI1101		IS-AI1130	●	●	
Anti-SS-A/Ro, IgG	IS-AI1102	●		●	●	
Anti-SS-A/Ro 52 kDa, IgG	IS-AI1103	●		●	●	
Anti-SS-A/Ro 60 kDa, IgG	IS-AI1104	●		●	●	
Anti-SS-B/La, IgG	IS-AI1105	●		●	●	
Anti-Sm, IgG	IS-AI1106	●		●	○	
Anti-U1-snRNP, IgG	IS-AI1107	●		●	●	
Anti-Scl-70, IgG	IS-AI1108	●		●	●	
Anti-Jo-1, IgG	IS-AI1109	●		●	●	
Anti-Centromera B, IgG	IS-AI1110	●		●	○	
Anti-cyklické citrulinované peptidy (CCP), IgG	IS-AI1201	IS-AI1230	●	●	●	100
	LA 1505-0100 G	LR 1505-0160 G	●	●	○	
Anti-kardiolipin, IgG	IS-AI1501	IS-AI1530	●	●	●	
Anti-kardiolipin, IgM	IS-AI1601	IS-AI1630	●	●	●	
Anti-β2 glykoprotein I, IgG	IS-AI1502	IS-AI1530	●	●	●	
Anti-β2 glykoprotein I, IgM	IS-AI1602	IS-AI1630	●	●	●	
Kalprotektin, cirkulující	IS-AI26100 ^a	IS-AI26030	●	●	●	
Revmatoidní faktor, celkový	RFCOL B00/IDS ^{1,2,b}	RFCOK-000/IDS ¹ RFCON-002/IDS ¹	●	●	○	100
Anti-myeloperoxidáza (MPO), IgG	IS-AI1701	IS-AI1730	●	●	●	50
	LA 1211-10010 G	LR 1211-20210 G	●	●	○	100
Anti-proteináza 3 (PR3), IgG	IS-AI1702II	IS-AI1730	●	●	●	50
	LA 1201-10010 G	LR 1201-20210 G	●	●	○	100
Anti-glomerulární bazální membrána (GBM), IgG	IS-AI1703	IS-AI1730	–	●	●	50
	LA 1251-10010 G	LR 1251-20210 G	●	●	○	100
Hepatologie						
Anti-AMA (M2), IgG	IS-AI1801	IS-AI1830	●	●	●	50
Anti-LKM 1, IgG	IS-AI1802	IS-AI1830	●	●	●	
Gastroenterologie						
Anti-gliadin (GAF-3X), IgA	LV 3011-10010 A	LR 3011-20210 A	●	●	○	100
Anti-gliadin (GAF-3X), IgG	LV 3011-10010 G	LR 3011-20210 G	●	●	○	
Anti-deamidovaný gliadin, IgA	IS-AI1301	IS-AI1330	●	●	●	
Anti-deamidovaný gliadin, IgG	IS-AI1302		●	●	●	
Anti-tkáňová transglutamináza (tTG), IgA	IS-AI1303	IS-AI1330	●	●	●	
Anti-tkáňová transglutamináza (tTG), IgG	IS-AI1401	IS-AI1430	●	●	●	50

^a Kalibrátory nejsou součástí testovacího systému; set kalibrátorů je dostupný samostatně pod č. IS-AI26020

^b Kalibrátory nejsou součástí testovacího systému; set kalibrátorů je dostupný samostatně pod č. RFREK-000/IDS

¹ Výrobce Diagam

² Imunokolorimetrický test

Analyt	Obj. č.		Přístroj			Počet testů
	Testovací systém	Kontroly	i10	iSYS	i20	
Kalprotektin, fekální	IS-AI26000 ^a	IS-AI26030	●	●	●	100
	LQ 6831-0100 W	LR 6831-0160 W	●	●	○	
Nefrologie						
Anti-receptor fosfolipázy A2 (PLA2R), IgG	LA 1254-10010 G	LR 1254-20210 G	●	●	○	100
Funkce štítné žlázy						
Anti-tyreoglobulin (TG), IgG	IS-AI1901	IS-AI1930	●	●	●	100
Anti-tyreoperoxidáza (TPO), IgG	IS-AI1902		●	●	●	

Produkt	Obj. č.	Obsah
Doplňkové produkty pro extrakci vzorkového materiálu		
Extrakční nádoby pro kalprotektin	IS-AI26040 ^c	100 ks
Zkumavky pro dávkování stolice, připravené k použití	ZE 6010-2 ^d	45 ks
Zkumavky pro dávkování stolice, neplněné	ZE 6010-3 ^d	100 ks

Kostní metabolismus

Analyt	Obj. č.		Přístroj			Počet testů
	Testovací systém	Kontroly	i10	iSYS	i20	
Deficience vitamínu D						
25-OH vitamín D	IS-2500N ^f	IS-2530N	●	●	●	100
Parathormon (PTH), intaktní	IS-3200	IS-3230	●	●	●	
Poruchy kostního obratu / CKD-MBD						
1,25-(OH) ₂ vitamín D	IS-2000 ⁶	IS-2030	○	●	●	100
	IS-2400 ⁷	IS-2430	●	●	●	
Kostní specifická alkalická fosfatáza (BALP)	IS-2800	IS-2830	●	●	●	
Osteokalcin (Oc)	IS-2900	IS-2930	●	●	●	
β-izomerizované C-terminální telopeptidy kolagenu typu I (CTX-I)	IS-3000N ^f	IS-3030N	●	●	●	
N-terminální propeptid prokolagenu typu I (PINP), intaktní	IS-4000	IS-4030	●	●	●	
Tartrát-rezistentní kyselá fosfatáza (TRAc P5b)	IS-4100	IS-4130	○	●	○	
Matrix Gla protein, defosforylovaný a nekarboxylovaný (dp-ucMGP)	IS-4700	IS-4730	●	●	●	

Imunopatologie

Analyt	Obj. č.		Přístroj			Počet testů	
	Testovací systém	Kontroly	i10	iSYS	i20		
Markery zánětu							
Nukleozom H3.1.	2001-02-01 ³	Součástí testovacího systému	●	●	○	100	
C-reaktivní protein (CRP)	CPTXL H00/IDS ^{1,4,e}	CPCON-002 ¹ CPCOX-002 ¹	●	●	○	190	

^a Kalibrátory nejsou součástí testovacího systému; set kalibrátorů je dostupný samostatně pod č. IS-AI26020

^c Použitelné v kombinaci s IS-AI26000

^d Použitelné v kombinaci s LQ 6831 W

^e Kalibrátory nejsou součástí testovacího systému; set kalibrátorů je dostupný samostatně pod č. CPREK-000 ¹

^f Kalibrátory nejsou součástí testovacího systému; set kalibrátorů je dostupný samostatně pod č. IS-XX20(N, NG)

¹ Výrobce Diagram

³ Výrobce Belgian Volition Srl

⁴ Imunoturbidimetrický test

⁶ Automatická extrakce

⁷ Manuální extrakce

Endokrinologie

Analyt	Obj. č.		Přístroj			Počet testů
	Testovací systém	Kontroly	i10	iSYS	i20	
Růst						
Lidský růstový hormon (hGH)	IS-3700	– ⁵	●	●	●	100
Inzulinu podobný růstový faktor I (IGF-I)	IS-3900	IS-3930	●	●	●	
Vazebný protein 3 pro inzulinu podobný růstový faktor (IGFBP-3)	IS-4400	IS-4430	●	●	●	
Adrenální funkce						
Aldosteron	IS-3300	IS-3330	●	●	●	100
Adrenokortikotropní hormon (ACTH)	IS-4500NG ^f	IS-4530NG	●	●	●	
Kortizol (sérum, plazma)	IS-4600 ^f	IS-4630	●	●	●	
Kortizol (sliny)	IS-4900	IS-4930	○	●	○	
Kortizol (moč)	IS-5800 ^f	IS-5830	●	●	●	
Hypertenze						
Aldosteron	IS-3300	IS-3330	●	●	●	100
Renin, přímý	IS-3400	IS-3430	●	●	●	
Sarkoidóza						
Angiotenzin konvertující enzym (ACE)	IS-5900	Součástí testovacího systému	●	●	●	100
Reprodukce						
Testosteron, celkový	IS-5000	IS-5030	●	●	●	100
17-OH progesteron	IS-5100	IS-5130	●	●	●	
Testosteron, volný	IS-5300	IS-5330	●	●	●	
Androstenedion	IS-5400 ^f	IS-5430	●	●	●	
Globulin vázající pohlavní hormony (SHbG)	IS-5600	IS-5630	●	●	●	
Prolaktin	IS-5700 ^f	IS-5730	●	●	●	

Produkt	Obj. č.	Obsah
Doplňkové reagenty		
Diluent A	IS-10DA	12 ml
Diluent B	IS-10DB	12 ml
Diluent C	IS-10DC	36 ml

Neurodegenerace

Analyt	Obj. č.		Přístroj			Počet testů
	Testovací systém	Kontroly	i10	iSYS	i20	
Alzheimerova choroba						
Beta-amyloid (1-40) (CSF)	LQ 6511-10010-L	LR 6511-20210-L	●	●	○	100
Beta-amyloid (1-42) (CSF)	LQ 6521-10010-L	LR 6521-20210-L	●	●	○	
Total tau (CSF)	LQ 6531-10010-L	LR 6531-20210-L	●	●	○	
pTau (181) (CSF)	LQ 6591-10010-L	LR 6591-20210-L	●	●	○	

^f Kalibrátory nejsou součástí testovacího systému; set kalibrátorů je dostupný samostatně pod č. IS-XX20 (N, NG)

⁵ Následující produkty výrobce Bio-Rad Laboratories mohou být použity jako kontrolní materiál: Lyphochek Immunoassay Plus Control: Trilevel (12 x 5 ml, obj. č. 370) nebo Trilevel MiniPak (3 x 5 ml, obj. č. 370X) nebo Level 1 (12 x 5 ml, obj. č. 371), Level 2 (12 x 5 ml, obj. č. 372) a Level 3 (12 x 5 ml, obj. č. 373); Lyphochek je ochrannou známkou Bio-Rad Laboratories.

TDM - Monitoring biologické léčby⁸

Analyt	Obj. č.		Přístroj			Počet testů
	Testovací systém	Kontroly	i10	iSYS	i20	
Adalimumab	CTA-002-100	Součástí testovacího systému	●	●	●	100
Anti-adalimumab	CTA-003-100		●	●	●	
Anti-adalimumab total	CTA-003T-50		●	●	●	
Certolizumab	CTC-002-50		●	●	●	50
Anti-certolizumab	CTC-003-50		●	●	●	
Etanercept	CTE-002-50		●	●	●	
Anti-etanercept	CTE-003-50		●	●	●	
Golimumab	CTG-002-50		●	●	●	
Anti-golimumab	CTG-003-50		●	●	●	
Infliximab	CTI-002-100		●	●	●	100
Anti-infliximab	CTI-003-100		●	●	●	
Anti-infliximab total	CTI-003T-50		●	●	●	
Ocrelizumab	CTO-002-50		●	●	●	50
Anti-ocrelizumab	CTO-003-50		●	●	●	
Rituximab	CTR-002-50		●	●	●	
Anti-rituximab	CTR-003-50		●	●	●	
Risankizumab	CTRZ-002-50		●	●	●	
Anti-risankizumab	CTRZ-003-50		●	●	●	
Ustekinumab	CTU-002-50	Součástí testovacího systému	●	●	●	50
Anti-ustekinumab	CTU-003-50		●	●	●	
Vedolizumab	CTV-002-50		●	●	●	
Anti-vedolizumab	CTV-003-50		●	●	●	

Produkt	Obj. č.	Obsah
Doplňkové interní kontroly kvality		
Adalimumab	CTA-002-PC	2 koncentrace (1 x 500 µl každá)
Anti-adalimumab	CTA-003-PC	2 koncentrace (1 x 1,5 ml každá)
Anti-adalimumab total	CTA-003T-PC	2 koncentrace (1 x 1,5 ml každá)
Certolizumab	CTC-002-PC	2 koncentrace (1 x 500 µl každá)
Anti-certolizumab	CTC-003-PC	2 koncentrace (1 x 1,5 ml každá)
Etanercept	CTE-002-PC	2 koncentrace (1 x 500 µl každá)
Anti-etanercept	CTE-003-PC	2 koncentrace (1 x 1,5 ml každá)
Golimumab	CTG-002-PC	2 koncentrace (1 x 500 µl každá)
Anti-golimumab	CTG-003-PC	2 koncentrace (1 x 1,5 ml každá)
Infliximab	CTI-002-PC	2 koncentrace (1 x 500 µl každá)
Anti-infliximab	CTI-003-PC	2 koncentrace (1 x 1,5 ml každá)
Anti-infliximab total	CTI-003T-PC	2 koncentrace (1 x 1,5 ml každá)
Ocrelizumab	CTO-002-PC	2 koncentrace (1 x 500 µl každá)
Anti-ocrelizumab	CTO-003-PC	2 koncentrace (1 x 1,5 ml každá)
Rituximab	CTR-002-PC	2 koncentrace (1 x 500 µl každá)
Anti-rituximab	CTR-003-PC	2 koncentrace (1 x 1,5 ml každá)
Risankizumab	CTRZ-002-PC	2 koncentrace (1 x 500 µl každá)
Anti-risankizumab	CTRZ-003-PC	2 koncentrace (1 x 1,5 ml každá)
Ustekinumab	CTU-002-PC	2 koncentrace (1 x 500 µl každá)
Anti-ustekinumab	CTU-003-PC	2 koncentrace (1 x 1,5 ml každá)
Vedolizumab	CTV-002-PC	2 koncentrace (1 x 500 µl každá)
Anti-vedolizumab	CTV-003-PC	2 koncentrace (1 x 1,5 ml každá)

⁸ Produkty výrobce Biosynex – Theradiag

Alergie

Alergen	Alergen	Obj. č.	Přístroj			Počet testů
	Kód	Testovací systém	i10	iSYS	i20	
Inhalační						
Roztoči – Dermatophagoides pteronyssinus	D001	IS-1D001	○	●	○	50
Roztoči – Dermatophagoides farinae	D002	IS-1D002	○	●	○	
rDer p 1 – Dermatophagoides pteronyssinus	D202	IS-1D202	○	●	○	20
rDer p 2 – Dermatophagoides pteronyssinus	D203	IS-1D203	○	●	○	
rDer p 10 – Dermatophagoides pteronyssinus	D205	IS-1D205	○	●	○	
Kočka epitel – Felis domesticus	E001	IS-1E001	○	●	○	50
Kůň epitel – Equus spp.	E003	IS-1E003	○	●	○	
Pes epitel – Canis spp.	E005	IS-1E005	○	●	○	
nFel d 1 – Felis domesticus	E094	IS-1E094	○	●	○	20
nCan f 1 – Canis familiaris	E101	IS-1E101	○	●	○	
Tomka vonná – Anthoxanthum odoratum	G001	IS-1G001	○	●	○	50
Troskut prstnatý – Cynodon dactylon	G002	IS-1G002	○	●	○	
Srha laločnatá – Dactylis glomerata	G003	IS-1G003	○	●	○	
Kostřava luční – Festuca elatior	G004	IS-1G004	○	●	○	
Jílek vytrvalý – Lolium perenne	G005	IS-1G005	○	●	○	
Bojínek luční – Phleum pratense	G006	IS-1G006	○	●	○	
Rákos obecný – Phragmites communis	G007	IS-1G007	○	●	○	
Lipnice luční – Poa pratensis	G008	IS-1G008	○	●	○	
Žito – Secale cereale	G012	IS-1G012	○	●	○	
Medyněk vlnatý – Holcus lanatus	G013	IS-1G013	○	●	○	
Oves – Avena sativa	G014	IS-1G014	○	●	○	
Pšenice – Triticum aestivum	G015	IS-1G015	○	●	○	20
Ječmen – Hordeum vulgare	G201	IS-1G201	○	●	○	
rPhl p 1 – Phleum pratense	G205	IS-1G205	○	●	○	
rPhl p 1, rPhl p 5b – Phleum pratense	G213	IS-1G213	○	●	○	
rPhl p 5b – Phleum pratense	G215	IS-1G215	○	●	○	50
Směs trav 3 – Lipnicovitě (obsahuje G001, G005, G006, G012, G013)	GX03	IS-1GX03	○	●	○	
Aspergillus fumigatus	M003	IS-1M003	○	●	○	
Alternaria alternata	M006	IS-1M006	○	●	○	20
rAlt a 1 – Alternaria alternata	M229	IS-1M229	○	●	○	
Olše – Alnus glutinosa	T002	IS-1T002	○	●	○	50
Bříza – Betula verrucosa	T003	IS-1T003	○	●	○	
Líška – Corylus avellana	T004	IS-1T004	○	●	○	
Olivovník – Olea europaea	T009	IS-1T009	○	●	○	
Jasan – Fraxinus excelsior	T025	IS-1T025	○	●	○	
rBet v 1 – Betula verrucosa	T215	IS-1T215	○	●	○	20
rBet v 2 – Betula verrucosa	T216	IS-1T216	○	●	○	
rOle e 1 – Olea europaea	T224	IS-1T224	○	●	○	
Ambrózie – Ambrosia artemisiifolia	W001	IS-1W001	○	●	○	50
Pelyněk – Artemisia vulgaris	W006	IS-1W006	○	●	○	
Jitrocel – Plantago lanceolata	W009	IS-1W009	○	●	○	
nAmb a 1 – Ambrosia artemisiifolia	W230	IS-1W230	○	●	○	20
nArt v 1 – Artemisia vulgaris	W231	IS-1W231	○	●	○	
Potravinové						
Vaječný bílek – Gallus spp.	F001	IS-1F001	○	●	○	50
Vaječný žloutek – Gallus spp.	F075	IS-1F075	○	●	○	
nGal d 1 – Gallus domesticus	F233	IS-1F233	○	●	○	20
Slepičí vejce – Gallus spp.	F245	IS-1F245	○	●	○	50
rPen a 1 – Penaeus aztecus	F351	IS-1F351	○	●	○	20
Kiwi – Actinidia spp.	F084	IS-1F084	○	●	○	50
rMal d 1 – Malus domestica	F434	IS-1F434	○	●	○	20

Alergen	Alergen	Obj. č.	Přístroj			Počet testů
	Kód	Testovací systém	i10	iSYS	i20	
Potravinové						
Kravné mléko – Bos spp.	F002	IS-1F002	○	●	○	50
Alfa-laktalbumin – Bos spp.	F076	IS-1F076	○	●	○	
Beta-laktoglobulin – Bos spp.	F077	IS-1F077	○	●	○	
Kasein – Bos spp.	F078	IS-1F078	○	●	○	
Treska – Gadus spp.	F003	IS-1F003	○	●	○	
Slávka – Mytilus spp.	F037	IS-1F037	○	●	○	
Arašíd – Arachis hypogaea	F013	IS-1F013	○	●	○	50
Sója – Glycine max	F014	IS-1F014	○	●	○	
Lískový oříšek – Corylus avellana	F017	IS-1F017	○	●	○	
Mandle – Amygdalus communis	F020	IS-1F020	○	●	○	
Kešu – Anacardium occidentale	F202	IS-1F202	○	●	○	
Pistácie – Pistacia vera	F203	IS-1F203	○	●	○	
Vlašský ořech – Juglans spp.	F256	IS-1F256	○	●	○	20
nAra h 2 – Arachis hypogaea	F423	IS-1F423	○	●	○	
rAra h 9 – Arachis hypogaea	F427	IS-1F427	○	●	○	
rCor a 1 – Corylus avellana	F428	IS-1F428	○	●	○	
Hmyzí jedy						
Včela – Apis mellifera	I001	IS-1I001	○	●	○	50
Vosa – Vespula spp.	I003	IS-1I003	○	●	○	
Atopie						
Latex – Hevea brasiliensis	K082	IS-1K082	○	●	○	50

Produkt	Obj. č.	Obsah
Doplňkové reagentie		
Celkové / specifické IgE, reagenční kit	IS-1TIGE900	50 / 200 ks
Celkové IgE, kontrolní set	IS-1TIGE930	3 koncentrace (1 x 1,2 ml každá)
Pozitivní kontrola, specifické IgE (G006), Bojínek luční	IS-1G006-30	1 koncentrace (2 x 1,2 ml)
Pozitivní kontrola, specifické IgE (F003), Treska	IS-1F003-30	1 koncentrace (2 x 1,2 ml)
Negativní kontrola, specifické IgE (F003/G006), Treska/ Bojínek luční	IS-1SIGE930	1 koncentrace (2 x 1,2 ml)

Infekce

● kompatibilní

○ deklarována plánovaná kompatibilita

– nekompatibilní

Analyt	Obj. č.		Přístroj			Počet testů
	Testovací systém	Kontroly	i10	iSYS	i20	
Herpetické infekce						
Anti-cytomegalovirus (CMV), IgG	IS-ID5401 ⁹	IS-ID5430 ⁹	–	●	○	100
Anti-cytomegalovirus (CMV), IgM	IS-ID5402 ⁹		–	●	○	
Anti-cytomegalovirus (CMV), IgG (avidita)	IS-ID5501 ⁹	IS-ID5530 ⁹	–	●	○	50
Anti-herpes simplex virus (HSV) 1, IgG	IS-ID5601 ⁹	IS-ID5630 ⁹	●	●	○	100
	LI 2531-10010 G	LR 2531-20210 G	●	●	○	
Anti-herpes simplex virus (HSV) 2, IgG	IS-ID5602 ⁹	IS-ID5630 ⁹	●	●	○	
	LI 2532-10010 G	LR 2532-20210 G	●	●	○	
Anti-herpes simplex virus (HSV) 1/2, IgM	IS-ID5701 ⁹	IS-ID5730 ⁹	●	●	○	
Anti-EBV VCA, IgG	IS-ID5801 ⁹	IS-ID5830 ⁹	●	●	○	
	LI 2791-10010 G	LR 2791-20210 G	●	●	○	
Anti-EBV VCA, IgM	IS-ID5802 ⁹	IS-ID5830 ⁹	●	●	○	
	LI 2791-10010 M	LR 2791-20210 M	●	●	○	
Anti-EBV EBNA-1, IgG	IS-ID5803 ⁹	IS-ID5830 ⁹	●	●	○	
	LI 2793-10010 G	LR 2793-20210 G	●	●	○	
Anti-EBV EA, IgG	IS-ID5804 ⁹	IS-ID5830 ⁹	●	●	○	50
Anti-VZV, IgG	IS-ID5903 ⁹	IS-ID5930 ⁹	●	●	○	
Anti-VZV, IgM	IS-ID6003 ⁹	IS-ID6030 ⁹	●	●	○	

⁹ Produkt výrobce Technogenetics

Infekce významné v těhotenství/ Onemocnění s dostupnou vakcínou						
Anti-Toxoplasma gondii (TOXO), IgG	IS-ID5001 ⁹	IS-ID5030 ⁹	–	●	○	100
Anti-Toxoplasma gondii (TOXO), IgM	IS-ID5002 ⁹		●	●	○	
Anti-Toxoplasma gondii (TOXO), IgG (avidita)	IS-ID5101 ⁹	IS-ID5130 ⁹	–	●	○	50
Anti-rubella virus, IgG	IS-ID5201 ⁹	IS-ID5230 ⁹	●	●	○	100
Anti-rubella virus, IgM	IS-ID5202 ⁹		●	●	○	
Anti-rubella virus, IgG (avidita)	IS-ID5301 ⁹	IS-ID5330 ⁹	●	●	○	50
Anti-parvovirus B19, IgG	IS-ID6301 ⁹	IS-ID6330 ⁹	●	●	○	
Anti-parvovirus B19, IgM	IS-ID6302 ⁹		●	●	○	
Anti-mumps virus, IgG	IS-ID5902 ⁹	IS-ID5930 ⁹	●	●	○	
Anti-mumps virus, IgM	IS-ID6002 ⁹	IS-ID6030 ⁹	●	●	○	
Anti-measles virus, IgG	IS-ID5901 ⁹	IS-ID5930 ⁹	●	●	○	
Anti-measles virus, IgM	IS-ID6001 ⁹	IS-ID6030 ⁹	●	●	○	
Anti-Clostridium tetani, IgG	IS-ID6101 ⁹	IS-ID6130 ⁹	●	●	○	
Respirační infekce						
Anti-SARS-CoV-2-RBD, IgG	LI 2606-10010-1 G	LR 2606-20210-1 G	●	●	–	100
Infekce přenášené klíšťaty						
Anti-Borrelia, IgG	IS-ID6201 ⁹	IS-ID6230 ⁹	●	●	○	100
	LI 2132-10010 G	LR 2132-20210 G	●	●	○	
Anti-Borrelia, IgM	IS-ID6202 ⁹	IS-ID6230 ⁹	●	●	○	
	LI 2132-10010 M	LR 2132-20210 M	●	●	○	

⁹ Produkt výrobce Technogenetics

Automatizace

Produkt	Obj. č.	Přístroj			Počet testů
		i10	iSYS	i20	
Cartridge Checking System (CCS)	IS-6010	●	●	●	784 testů
Kyvety	IS-CC100	●	●	●	960 ks
Trigger Set	IS-CT100	●	●	●	2 x 250 ml
D-SORB Solution	IS-DS200	●	●	●	2 x 1 l
System Liquid - systémový roztok	IS-CS100	●	●	●	5 l
Wash Solution - promývací roztok	IS-CW100	●	●	●	10 l
Cleaning Solution - čistící roztok	IS-HS100	●	●	●	15 x 45 ml
Immunocleaner	IS-IM100	●	●	●	6 x 27 ml


Přístroj	Obj. č.
IDS-i10	IS-810400
IDS-iSYS Multi-Discipline Automated System	IS-310400
IDS i20	IS-910400

● kompatibilní ○ deklarována plánovaná kompatibilita – nekompatibilní

Veškeré CLIA testy jsou zpracovávány automaticky na analyzátoch IDS-i10, IDS-iSYS Multi-Discipline Automated System nebo IDS i20. Informace ke konkrétnímu produktu či specifické šarži jsou poskytovány na mini-CD, čárovém 2D kódu nebo RFID kartě, v závislosti na použité testovací soupravě.



IDS-i10

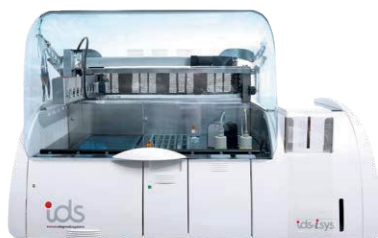

IDS-iSYS Multi-Discipline Automated System



IDS i20

veškeré CLIA testy